


data: 15-Nov-2018, godz.: 13:39:15, próbka: DMK044

ZQ77808 1 (0.101)

Scan ES-  
3.87e8

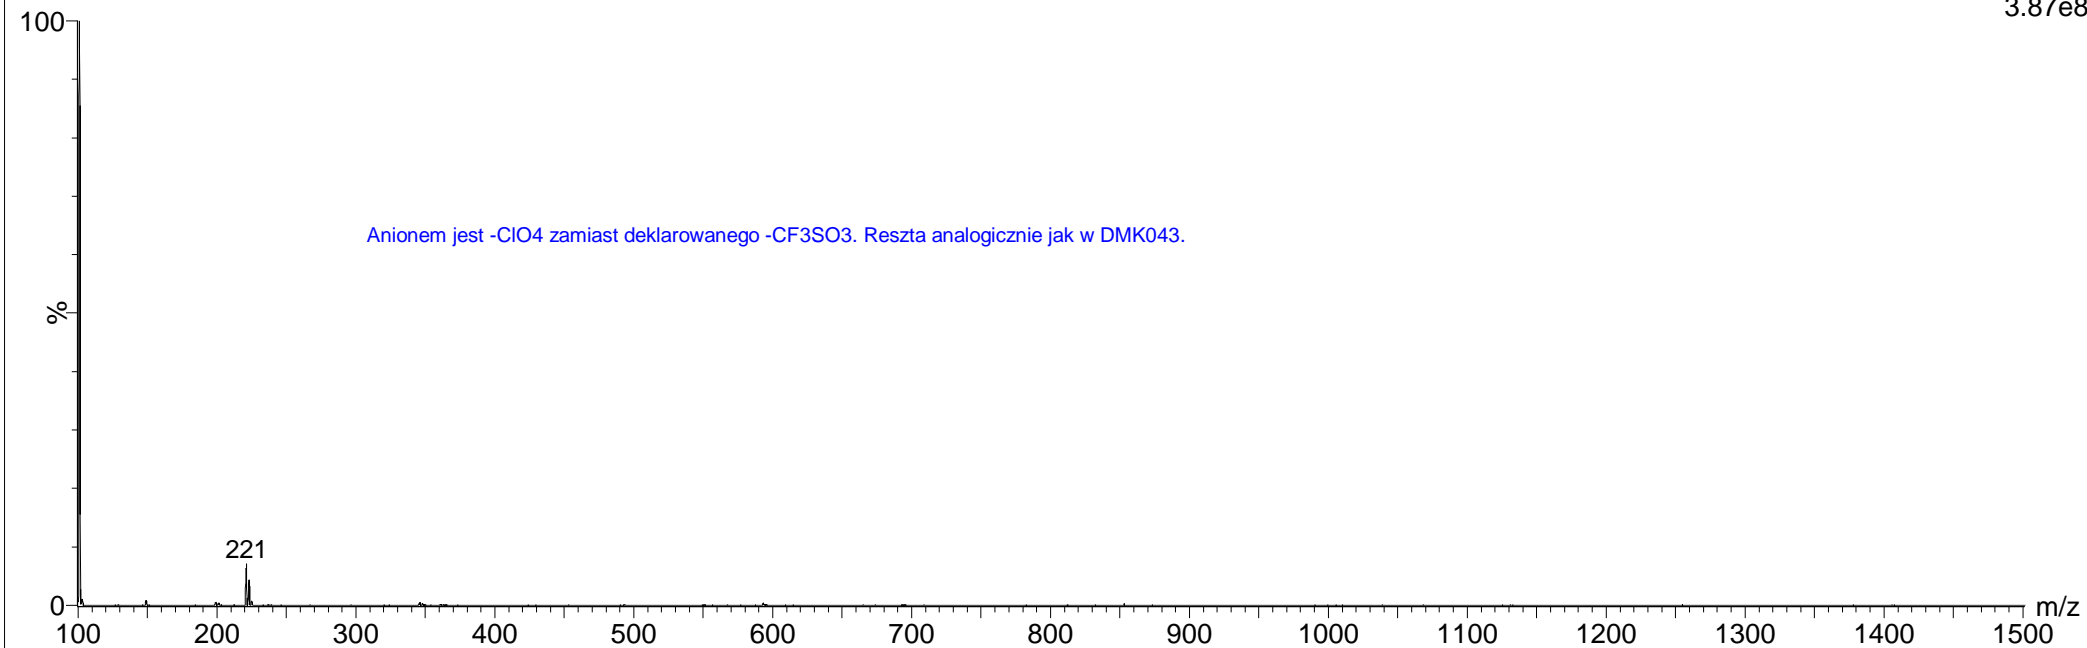

Anionem jest  $\text{-ClO}_4$  zamiast deklarowanego  $\text{-CF}_3\text{SO}_3$ . Reszta analogicznie jak w DMK043.

ZQ77807 1 (0.101)

Scan ES+  
2.90e8

